

สรุปรายงานการประชุม

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการขอเปิดหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เขตสุขภาพที่ ๘

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ระบบ Zoom Meeting ID : 386 988 1744 Passcode : r8waymoph

รายชื่อคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--------------------------------------|---|--------|
| ๑. นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ | ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ ๘ | ประธาน |
| ๒. นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | |
| ๓. นายแพทย์พิสิฐ อินทรวงษ์โชติ | นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธาน Service Plan สาขาไต
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย | |
| ๔. แพทย์หญิงพริณี สัพโส | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน
โรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร | |
| ๕. แพทย์หญิงกัลยารัตน์ อินทบุญศรี | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม
โรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี | |
| ๖. แพทย์หญิงกัญญาภักดิ์ ศิลารักษ์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร | |
| ๗. แพทย์หญิงจิรัฐติกาล สุตวณิชย์ | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย
โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร | |
| ๘. นายแพทย์ประจักษ์ เทิกขุนทด | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว
โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร | |
| ๙. แพทย์หญิงปัทมาพร คำใจ | นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี | |
| ๑๐. แพทย์หญิงภัทราพร วงศ์พัฒ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย | |
| ๑๑. นายแพทย์ปิ่นพงศ์ศานต์ ตรียาวธัญญ | นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย | |
| ๑๒. แพทย์หญิงธนีสร์ คำริห์ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ | |
| ๑๓. นายแพทย์อรรถสุวรรณต วลัยขพฤกษ์ | นายแพทย์ชำนาญการ
โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี | |
| ๑๔. เกสัชกรพีระศักดิ์ คำสงค์ | เภสัชกรชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร | |

๑๕. นางรุ่งรัชช์ ภิรมย์ลาภ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร
๑๖. นางสาวสุนทรี วิษาเครื่อง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเลย จังหวัดเลย
๑๗. นางสุภาพร ไชยวัฒนตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. นางสาวนลญา สุวรรณไตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
๑๙. นางสาวมัทนา สุวรรณมาโจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
๒๐. นางรุ่งนภา ไชยชนะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
๒๑. นางสาวมณฑิรา อังกาสี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
๒๒. นางสาวสุทิสรา ทองพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
๒๓. นางสาวนภาพร ลิขัยมูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
๒๔. นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เลขานุการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘
๒๕. นางจิราภรณ์ สุทธิบริบาล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘

รายชื่อคณะกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดราชการ

๑. นายแพทย์วิเศษศิลป์ พันธุ์นาคำ	ติดราชการ
๒. แพทย์หญิงจุฬารัตน์ บุญทศ	ติดราชการ
๓. แพทย์หญิงวราภรณ์ ศรีภักดี	ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

กล่าวเปิดการประชุม

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘ ประธานชี้แจง โรงพยาบาลอุดรธานี มีนวัตกรรมให้บริการพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบ รถ Mobile unit โดยนำรถ Ambulance มาพัฒนาปรับปรุง เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และแนะนำให้โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ ๘ ที่มีผู้ป่วยโรคไตที่มารับบริการไม่สะดวก สามารถทำ รถ Mobile unit ให้บริการใน รพช. , รพ.สต. ที่ไม่มีหน่วยพอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้รับบริการได้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงพยาบาลอุดรธานี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกันกรา ชั้น ๕ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลกุดจับ จังหวัดอุดรธานี โดย นางสาวมันทนา สุวรรณมาโจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นำเสนอ ดังนี้

โรงพยาบาลกุดจับ ได้เปิดดำเนินการในส่วนของอาคาร สถานที่ ซึ่งได้ผู้รับเหมาแล้ว กำลังดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องที่ติดตั้ง ๒๔ เครื่อง โดยมีที่ปรึกษา คือ แพทย์หญิงปัทมาพร คำใจ โรงพยาบาลอุดรธานี ส่งมอบอาคารเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งได้ติดตั้งลิฟท์เชื่อมชั้น ๑ กับชั้น ๒ เสร็จแล้ว สามารถให้บริการได้ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี โดย นายแพทย์อรรถสรวรต วลัยภูพฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการ นำเสนอ ดังนี้

โรงพยาบาลโนนสะอาด สถานที่ดำเนินการ อาคารพัสดุโรงพยาบาลโนนสะอาด รูปแบบการดำเนินการแบบ Outsource จำนวนที่ขออนุมัติ ๑๒ เครื่อง จากข้อเสนอแนะปรับปรุงแปลนผังอาคารในการประชุมขออนุมัติเปิดศูนย์ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้เน้นย้ำเรื่องเก็บน้ำ ระบบระบายน้ำในจุดที่ ๔ และ จุดที่ ๕ ให้มีประตูเชื่อมกับโซนให้บริการและประตูเชื่อมกับอาคารภายนอก และเน้นย้ำห้องล้างตัวกรองให้มีฉากกั้นระหว่างอ่างล้างทั้ง ๔ อ่าง ซึ่งได้ปรับปรุงในแปลนเรียบร้อยแล้ว



การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจคุณภาพ ropic บริษัท Outsource เข้าปรับปรุงพื้นที่คาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงเรื่องสถานที่ให้เสร็จภายใน ธันวาคม ๒๕๖๖ นี้

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๓ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
โดย แพทย์หญิงกัญลารัตน์ อินทบุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำโสม นำเสนอดังนี้

โรงพยาบาลน้ำโสม จากเดิมได้อนุมัติใช้ตึกผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง แต่เนื่องจากผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีจำนวนเพิ่มขึ้นจึงได้ใช้ตึกผู้ป่วยใน ส่วนตึกศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลน้ำโสมจะเป็นตึกสร้างใหม่ การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนเตรียมพื้นที่ จำนวนที่ขออนุมัติ ๑๒ เครื่อง คาดการณ์ผู้ป่วยที่จะรับบริการ ๗๐ คน สามารถให้บริการได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร
โดย แพทย์หญิงกัญญาภักดิ์ ศิลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร นำเสนอดังนี้

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร การดำเนินงานอยู่ในขั้นตอน เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา คาดว่าประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแจ้งทำสัญญา การปรับปรุงสถานที่หลังจาก ลงนามในสัญญาใช้เวลาประมาณ ๓ เดือน สามารถให้บริการได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๕ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลอากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
โดย แพทย์หญิงจิรัฐติกา สุตวณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอากาศอำนวย นำเสนอดังนี้

โรงพยาบาลอากาศอำนวย การดำเนินงานอยู่ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินงานจัดทำสัญญา บริษัท ผู้รับเหมามีขั้นตอนในการปรับปรุงพื้นที่หน่วยฟอกไตระยะเวลา ๙๐ วัน ขั้นตอนในการตรวจสอบตามมาตรฐาน ตรต. ระยะเวลา ๙๐ วัน การตรวจสอบน้ำระบบล้างไต ทุกๆ ๑ เดือน ติดต่อกัน ๓ เดือน

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๖ รายงานความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนคร
โดย แพทย์หญิงพิรุณี สัพโส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังโคน นำเสนอดังนี้

โรงพยาบาลพังโคน การดำเนินงานอยู่ขั้นตอนจะเริ่มปรับปรุงสถานที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สามารถ ให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รอเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่อง ไตเทียมประมาณ ๖๒ ราย คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ในศูนย์ฟอกเลือดที่ให้บริการในจังหวัดสกลนคร ๓๘ ราย

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องพิจารณา

๔.๑ ขออนุมัติจัดตั้งการเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลส่องดาว

โดย นายแพทย์ประจักษ์ เทิกขุนทด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่องดาว นำเสนอดังนี้

อำเภอส่องดาวห่างจากอำเภอเมืองสกลนคร ๑๐๕ กิโลเมตร โรงพยาบาลส่องดาว ประชากร ๓๔,๕๖๒ คน อัตรากำลังบุคลากรโรงพยาบาลมีทั้งหมด ๑๗๑ คน เครื่องข่ายรับส่งต่อของโรงพยาบาล ห่างจาก รพ.สว่างแดนดิน ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลสกลนคร ระยะทาง ๑๒๙ กิโลเมตร มีรพ.สต.ในพื้นที่ ถ่ายโพนทั้ง ๔ แห่ง

๑. คาดการณ์จำนวนผู้ป่วยที่จะเข้ารับบริการ

- ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่รอเข้ารับบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประมาณ ๖ ราย ผู้ป่วยที่ ปฏิเสธ RRT ๓๓ ราย เนื่องจากปัญหาในการเดินทางและคนดูแล คาดการณ์ว่าถ้ามีหน่วยไตเทียมใกล้บ้านจำนวน คนใช้ทำ RRT จะมีการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น

๒. ผู้ป่วยที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาในหน่วยไตเทียม รพ. อื่น จำนวน ๓๐ ราย ดังนี้

- คลินิกไตสว่างวัฒนะ จำนวน ๑๘ ราย
- รพร.สว่างแดนดิน จำนวน ๑๒ ราย

๓. ระบบการกำกับติดตาม และการประเมินคุณภาพการบริการ

๔. แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการ

๕. แผนผังโครงสร้างและเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม

๖. แบบบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน

๗. การประเมินและติดตามผู้ป่วย

๘. กระบวนการพัฒนาหน่วยไตเทียม

๙. แผนรองรับการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต

แผนรองรับการจัดตั้งศูนย์ฟอกไต โรงพยาบาลส่องดาว

๑. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการ
๒. สถานที่ที่จัดตั้งศูนย์ฟอกไต
๓. เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ที่เตรียมให้บริการในหน่วยไตเทียม
๔. การให้บริการตรวจ LAB และการรักษา
๕. อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต (CPR)
๖. ระบบน้ำบริสุทธิ์ การบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม การจัดการขยะติดเชื้อ และระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องมือและบุคลากรทางการแพทย์ที่เตรียมให้บริการในหน่วยไตเทียม

- อายุรแพทย์โรคไต จำนวน ๑ คน รพร.สว่างแดนดิน
- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม จำนวน ๑ คน (บริษัทเอกชน)
- พยาบาลไตเทียม จำนวน ๑ คน (บริษัทเอกชน)
- โรงพยาบาลแม่ข่าย ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน และ โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

ระบบการกำกับติดตาม และการประเมินคุณภาพการบริการ


- ประเมินคุณภาพการบริการ ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข และจัดทำรายงานข้อมูลพื้นฐานและการประเมินตนเอง เพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการรักษา โดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐาน การรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.)

- ประเมินคุณภาพการกำจัดของเสียและขยะติดเชื้อ ตาม มาตรฐาน IC
- รายงานผลตัวชี้วัดคุณภาพ ทุก ๓ เดือน

พื้นที่การดำเนินการเปิดบริการ HD

สถานที่ อาคารพัสดุเดิมโรงพยาบาลส่องดาว มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๖๐ ตารางเมตร ส่วนบริการฟอกเลือด HD Station = ๑๒๘ ตารางเมตร ศักยภาพพร้อมบริการ ๘ เตียง

แบบแปลนหน่วยไตเทียมของโรงพยาบาลส่องดาว



แนวทางการดำเนินการเปิดหน่วยไตเทียม

- อายุรแพทย์โรคไต พญ.กฤษดี พิเศษพิชญา (รพร.สว่างแดนดิน)
- มีแพทย์ของ รพ.ส่องดาว Round case อย่างน้อย ๑ ครั้ง/วัน
- ดำเนินการจ้างเหมาบริษัทเอกชนเข้าร่วมดำเนินการโดยวิธีประกวดราคา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e bidding) ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน

การให้บริการ

- บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน ๘ เตียง
- ให้บริการผู้ป่วยทุกสิทธิและผู้ป่วยชำระค่ารักษาพยาบาล
- เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันเสาร์ วันละ ๓ รอบ เวลา ๐๕.๐๐-๒๐.๐๐ น.

แผนผังโครงสร้างและเจ้าหน้าที่หน่วยไตเทียม


- พยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียม ๑ คน
- พยาบาลไตเทียม ๑ คน
- พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย ๒ คน
- ธุรการไตเทียม ๑ คน
- แม่บ้าน ๑ คน

ระบบน้ำบริสุทธิ์

ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบ IN DIRECT FEED

- มีสัญญาบำรุงรักษา
- มีการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่สมาคมโรคไตกำหนด
- ใช้น้ำประปาเป็นแหล่งน้ำดิบ
- ตรวจ C/S ทุก ๑ เดือน
- มีถังสำรองน้ำดิบเพียงพอต่อการให้บริการ
- ตรวจ ENDOTOXIN ทุก ๓ เดือน
- สามารถผลิตน้ำ RO ประมาณ ๘๐๐ ลิตร /ชั่วโมง
- ตรวจมาตรฐานของ AAMI ทุก ๑ ปี

แผนผังท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลส่องดาว อำเภอส่องดาว

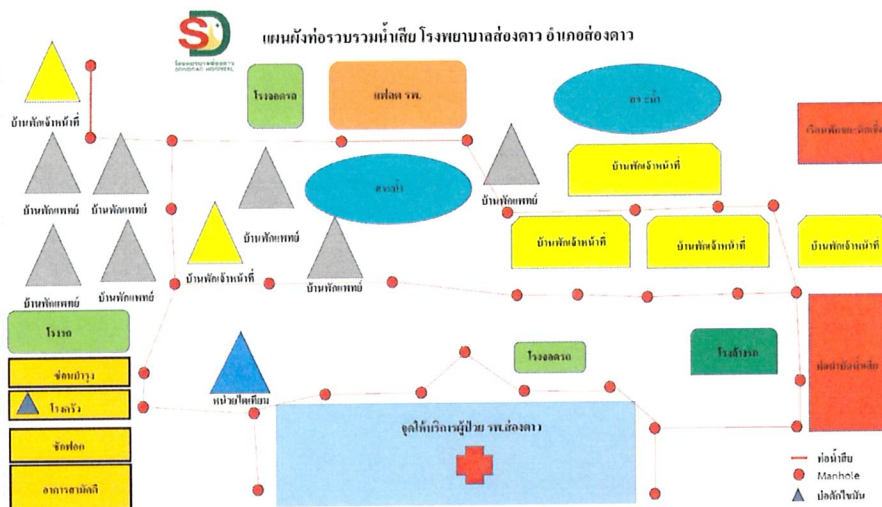

๗/ เครื่องไตเทียม...

เครื่องไตเทียมและการบำรุงรักษา

- มีการดูแลภายในเครื่องโดย DISINFECTION หลังฟอกเสร็จรอบต่อรอบ
- ทำความสะอาดภายนอกเครื่องไตเทียมด้วยผงซักฟอกและน้ำสะอาด
- ในกรณีเปื้อนเลือดใช้ทำความสะอาดด้วย ๐.๕% HYPOCHLORITE
- มีการแยกโซนผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี ผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี
- มีการทำความสะอาดตัวกรองด้วยวิธี MANUAL
- อบด้วยน้ำยา PERACITIC ความเข้มข้น ๐.๑๖ %
- ไม่ใช้ BLOOD LINE ชั่ว

อุปกรณ์และยาในการช่วยชีวิต

- มียา Emergency และอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมใช้
- มีเปลนอนสำหรับเคลื่อนย้าย และทีม CPR

แบบบันทึกและคู่มือการปฏิบัติงาน

- มีการลงทะเบียนแบบบันทึก TRT 1
- มีแบบบันทึกสำหรับการบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- มีบันทึกคำยินยอมฟอกเลือดผู้ป่วย
- มีแบบบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- มี Hemodialysis prescription ครั้งแรก และทบทวนทุก ๓ เดือน
- คู่มือการปฏิบัติการ (Work Instruction)

การประเมินและติดตามผู้ป่วย

- มีการตรวจเยี่ยมโดยอายุรแพทย์โรคไตทุก ๒ สัปดาห์
- มีการตรวจ ROUTINE LAB ทุก ๑ เดือน
- มีการตรวจเลือดประเมิน KT/V ทุก ๓ เดือน
- มีการตรวจ HBsAB , HBsAg, Anti HCV ทุก ๖ เดือน
- มีการตรวจ iPTH ทุก ๖ เดือน Iron study เมื่อแรกรับและทุก ๖ เดือน
- มีการตรวจ Anti HIV, CXR,EKG ทุก ๑ ปี
- มีการประเมิน VASCULAR ACCESS เมื่อพบปัญหา

กระบวนการพัฒนาหน่วยไตเทียม

- มีการซักประวัติและตรวจร่างกายก่อนฟอกเลือด เพื่อแก้ปัญหาและลดภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือด
- มีการบันทึกอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, เก็บข้อมูล KPI ของ

หน่วยงาน

- มีการพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้าร่วมงานประชุม/อบรมประจำปีของสมาคมโรคไตและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง

แพทย์หญิงปัทมาพร คำใจ อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลอุดรธานี ให้คำแนะนำการดูแลผู้ป่วย กรณีที่ไม่มีอายุรแพทย์ประจำ เสนอให้แพทย์ประจำโรงพยาบาลประสานกับอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแล ให้อายุรแพทย์ได้พบผู้ป่วยโรคไต ๑ วัน/สัปดาห์ เพื่อดูแลเรื่องยา ให้คำแนะนำ และดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่สอง ห้องแยก อยากให้ทุกหน่วยที่สร้างใหม่จัดห้องแยก ๑ ห้อง เพื่อรองรับผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจที่มีอาการไม่รุนแรงสามารถฟอกเลือดที่นี้ได้เลย โดยไม่ต้องส่งต่อ

นางสาวนลญา สุวรรณไตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบึงกาฬ เสนอที่ประชุม

ระบบ Emergency หน่วยที่ขอเปิดส่วนใหญ่อยู่ออกจากตึกผู้ป่วยมากกว่า ๕๐ เมตร ในบริบท Outsource ที่ดำเนินในโรงพยาบาล จะมีข้อจำกัดในเรื่องของพยาบาล ต้องเพิ่มสมรรถนะ ศักยภาพในการดูแล ประเมินคนไข้ เพราะเวลาผู้ป่วยเกิด Emergency จะไม่เกิดขึ้นบ่อย อยากให้ทุกโรงพยาบาลเชื่อมระบบ Emergency ให้ชัดเจน การทบทวนประเมินคนไข้ การช่วยเหลือคนไข้ Emergency ให้กับทีม Outsource เพื่อจะได้เชื่อมต่อในการดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : เห็นชอบ/อนุมัติให้เปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๘

ให้แต่ละจังหวัดสำรวจอายุรแพทย์โรคไต มีจำนวนเท่าไร เพราะบางจังหวัดมีแพทย์น้อย อยากให้แต่ละจังหวัดหาวิธีจัดสรรอายุรแพทย์โรคไต เพื่อวางแผนพัฒนารองรับต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางจิราภรณ์ สุทธิบริบาล)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายวีระวัฒน์ ศิริรัตน์ไพบูลย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เลขานุการ